


PAZIENTE DEMO:	Mario Rossi (cliente_demo)	STRUTTURA:	Farmacia di Prova
CODICE FISCALE:	DEMO0000000000001	PRESTAZIONE:	ECG a riposo (12 derivazioni)
DATA ESECUZIONE:	20/10/2026 · ore 10:30	TARATURA:	25 mm/s · 10 mm/mV · Filtro 50 Hz
PARAMETRI:	FC 68 bpm · PR 156 ms · QRS 88 ms · QT/QTc 384/402 ms · Asse P/QRS/T +54° / +48° / +42°		

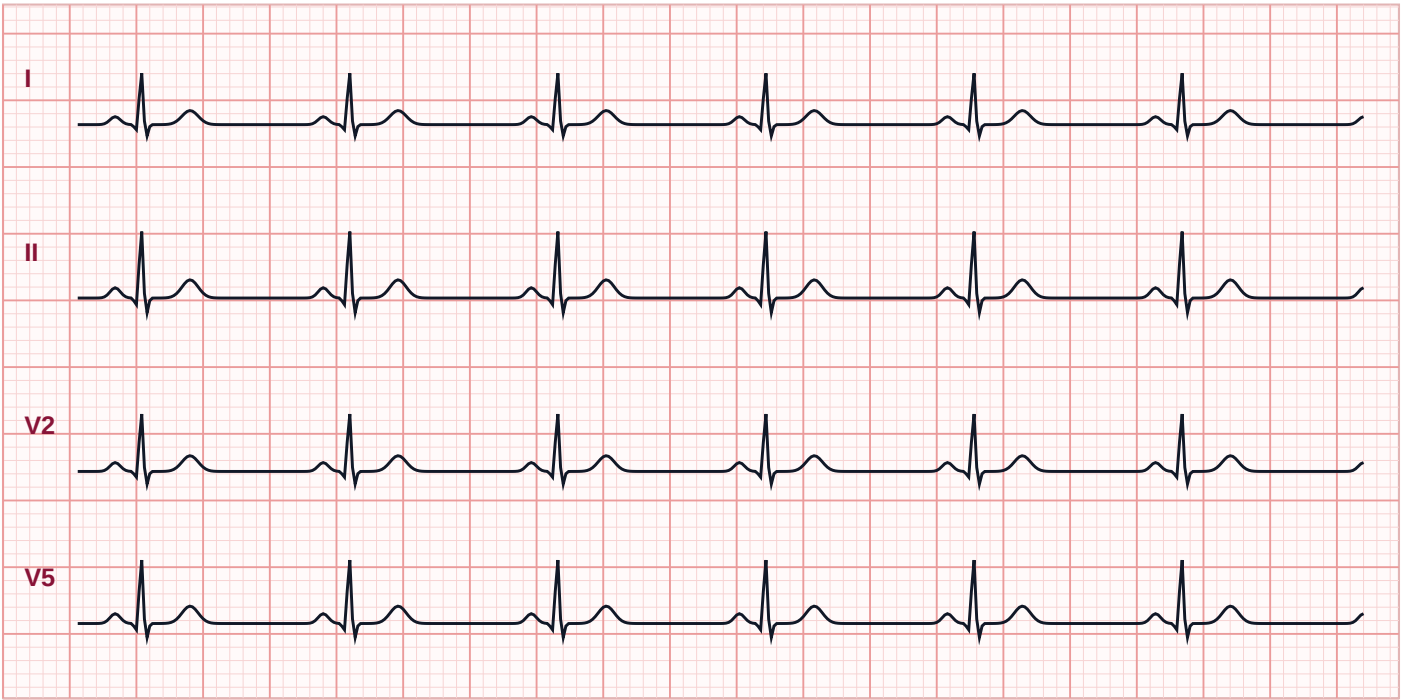

CONCLUSIONI ELETTRICHE DIMOSTRATIVE (SIMULAZIONE PILOT)

- Ritmo sinusale regolare a frequenza cardiaca media di 68 bpm.
- Conduzione atrio-ventricolare (PR 156 ms) e intraventricolare (QRS 88 ms) nei limiti fisiologici simulati.
- Fase di ripolarizzazione ventricolare regolare (QTc Bazett 402 ms); assenza di alterazioni ST-T nel tracciato fittizio.
- Documento generato automaticamente per collaudo app Saluvia (cliente_demo) e portale SaluviaWeb (Farmacia di Prova).

ATTESTAZIONE DI CONSENSO SU TABLET E CONSEGNA DIGITALE CERTIFICATA

☒ Presa visione informativa privacy confermata separatamente sul tablet della Farmacia di Prova

☒ Consenso specifico alla prestazione di Telecardiologia confermato prima dell'esecuzione

Verifica integrità documento: SHA-256 attivo · Consegna nell'app Saluvia valida per 30 giorni